

Dovozce a distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 1800/136
142 00 Praha 4
Česká republika
Zelená linka: +420 800 111 077
info@promedica-praha.cz
www.diabetes.ascensia.com

Microlet® next Odběrové zařízení CS

PŘÍBALOVÁ INFORMACE S POKYNY

- Vysouvací zařízení pro lancety pro bezpečnou likvidaci lancet.
- Černý/bílý** nastaviteľný koncový uzávěr, pouze pro testovanie z konečku prstú.
- Číra** koncovka pre OJM, pouze odběr z jiného mesta.

Používajte s lancetami MICROLET® pro testovanie z konečku prstú a ze dlaní.

UPOZORNĚNÍ

- Zeptejte se zdravotníckého odborníka, že je pro vás odběr z jiného mesta (OJM) vhodný.
- Zařízení pro kontinuální monitorování hladiny glukózy ne smí kalibrat podle výsledků testu odběru z jiného mesta (OJM).
- Dávka inzulinu ne smí vypočítávať podle výsledků testu odběru z jiného mesta (OJM).

UPOZORNĚNÍ: Potenciálne biologické nebezpečí

- Odběrové zařízení MICROLET NEXT je určené k samostatnému testovaniu jediným pacientom. Z dôvodu rizika infekcie jej nesmí používať viac osôb.
- Lancety nepoužívajte opakovane. Použité lancety nejsou sterilní. Pro každé testovanie použijte novou lancetu.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

EC REP Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care

90011574 Rev. 08/23

Dováža a distribuuje:
Bio G, spol. s r.o.
Elektrárenská 12092
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 4552 6381
E-Mail: biog@biog.sk
www.biog.sk
www.diabetes.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

EC REP Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care

90011574 Rev. 08/23

Importér i dystrybutor:
Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
POLSKA
Tel: +48 22 372 72 20
Bezpłatna linia do pacjentów:
800 999 090
Od poniedziałku do piątku
W godz. od 9.00 do 17.00.
info@diabetes.ascensia.pl
www.diabetes.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

EC REP Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Varesina, 162
20156 Milano, Italy

ASCENSIA
Diabetes Care

90011574 Rev. 08/23

Microlet® next Odberové zariadenie SK

PRÍBALOVÝ LETÁK

- Vysuvať lancety umožňujúci bezpečnú likvidáciu lancet.
- Čiernobiele** nastaviteľný koncový uzáver len na meranie z končeka prsta.
- Priehľadný** koncový uzáver AM len na meranie z alternatívneho miesta.

Používajte s lancetami MICROLET® na meranie z končeka prsta a z dlaní.

VÝSTRAHA

- Opýtajte sa zdravotníckeho personálu, či je pre vás vhodné meranie z alternatívneho miesta (AM).
- Pri stroji na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy nekalibrujte podľa výsledku získaného z merania z alternatívneho miesta.
- Dávku inzulinu nepočítajte podľa výsledku získaného z merania z alternatívneho miesta.

VÝSTRAHA: Potenciálne biologické riziko

- Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na samovystretenie pre jedného pacienta. Nesmí ho používať viac ako jedna osoba z dôvodu rizika infekcie.
- Lancety nie sú určené na opakovane používanie. Použité lancety nie sú sterilné. Pri každom meraní použite novú lancetu.

Microlet® next Nakluwacz PL

ULOTKA Z INSTRUKCJAMI

- Przycisk do usuwania lancetu w celu bezpiecznego usuwania.
- Czarno-szara końcówka nakluwacza z pokretem regulującym tylko do badania krwi z opuszkiem palca.
- Przeczysta końcówka do AST tylko do badań z alternatywnego miejsca naklucia.

Używać z lancetami MICROLET® do badania krwi pobranej z opuszki palca lub dloni.

OSTRZEŻENIE

- Należy zapytać lekarza, czy wykonywanie badań z alternatywnego miejsca naklucia (AST) jest dla danego użytkownika odpowiednie.
- Nie należy wykorzystywać wyników badania z AST do kalibrowania urządzenia do ciągłego monitorowania stężenia glukozy. Produkt dostępny na żądanie od Działu Obsługi Klienta.

OSTRZEŻENIE: Potencjalne zagrożenie biologiczne

- Nakluwacz MICROLET NEXT jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w jednym pacjencie. Nie należy go używać do nadmiernego bliżnaczenia, które mogłyby doprowadzić do utraty wrażliwości.
- Badania stężenia glukozy we krwi należy wykonywać z częstotliwością zalecaną (do głębokości naklucia).

*Może nie należeć do wszystkich zestawów. Produkt dostępny na żądanie od Działu Obsługi Klienta.

Nie korzystać z AST w przypadku:

- Podejrzenia, że stężenie cukru we krwi jest niskie (hipoglikemia).
- Gdy stężenie cukru we krwi gwałtownie się zmienia (po posiłku, dawce insuliny lub wysiłku fizycznym).
- Gdy nie odziera się objawów niskiego stężenia cukru we krwi (bezobjawowa hipoglikemia).
- Przed i po badaniu lub użyciu glukometru, nakluwacza lub pasków testowych należy zawsze umyć ręce wodą i mydlem oraz dokładnie je osuszyć.

PRZESTROGA:

- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia z jakiegokolwiek powodu lub trudności w obsłudze urządzenia należy skontaktować z Działem obsługi klienta.
- Naklucia należy wykonywać w różnych miejscach, aby nie dopuścić do nadmiernego bliżnaczenia, które mogłyby doprowadzić do utraty wrażliwości.
- Badania stężenia glukozy we krwi należy wykonywać z częstotliwością zalecaną (do głębokości naklucia).

Agnie ds. zdrowia zaleca, aby dorosły pacjenci badali stężenie glukozy we krwi od trzech do czterech razy dziennie (2018 U Oja et al., "Disruption in the diabetic device care market"), a dzieci i młodzież co najmniej pięć razy dziennie (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

Microlet® next Odběrové zařízení CS

URČENÉ POUŽITÍ: Určeno k odběru kapilární krve, k použití společně s jednorazovými lancetami. **Odběrové zařízení MICROLET NEXT** se používá spolu s kompatibilními lancetami k odběru kapilární krve ze špičky prstu nebo z dlaně pro testování hladiny glukózy v krvi. Odběrové zařízení MICROLET NEXT je určeno pro jednoho pacienta. Odběrové zařízení není určeno pro novorozence. **Lanceta MICROLET** je jednorázová sterilní zařízení určené k odběru vzorku kapilární krve dospehlého nebo dítěte pro sledování glykémie. Lanceta není určena k použití u novorozenců. U této zařízení nejsou známy žádné kontraindikace.

POZOR:

- Použití testovací proužky a lancety vždy likvidujte jako zdravotnický odpad nebo podle pokynů zdravotnického odborníka.
- Pokaždé si umyjte ruce mydlem a dobře je vysušte před testem a po manipulaci a po manipulaci s glukometrem, odběrovým zařízením nebo testovacími proužky.
- Použití testovacími proužky.

UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Souprava obsahuje malé části, které mohou v případě náhodného spolknutí způsobit udusení.
- Lanceta zůstává sterilní, dokud není odstraněn kulatý ochranný kryt. Nepoužívejte v případě poškození nebo neúmyslného otevření lancety. Likvidujte jako zdravotnický odpad, abyste zabránili případnému poranění.

UPOZORNĚNÍ: Potenciální biologické nebezpečí

- Odběrové zařízení MICROLET NEXT je určeno k samostatnému testování jediným pacientem. Z důvodu rizika infekce jej nesmí používat více osob.
- Lancety nepoužívajte opakovane. Použité lancety nejsou sterilní. Pro každé testování použijte novou lancetu.

Microlet® next Odberové zariadenie SK

ÚČEL POUŽITIA: Určené na odber kapilárnej krvi. Používa sa spolu s jednorazovými lancetami. **Odberové zariadenie MICROLET NEXT** sa používa na odber kapilárnej krvi z brusky prsta alebo z dlaní na meranie hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy. Lanceta nie je určená na použitie u novorodenca. S týmto pomocníkmi nie sú spojené žiadne kontraindikácie.

MERANIE Z AM NEVYKONÁVAJTE ZA NASLEDUJUJUCH PODMÍNKOM:

- ak si myslíte, že máte nízkú hladinu glukózy v krvi (hypoglykémia),
- ak sa vám prudko mení hladina glukózy v krvi (po jedle, dávke inzulinu alebo cvičení),
- ak nedokážete rozpoznať príznaky nízkej hladiny glukózy v krvi (nepoznaná hypoglykémia),
- ak výsledky merania hladiny glukózy v krvi z alternatívneho miesta nezodpovedajú tomu, ako sa cítite, počas choroby alebo v čase stresu,
- ak budete ťažiť auto alebo obsluhovať stroje.

UPOZORNENIE:

- Ak bude mať vaše zariadenie z nejakého dôvodu poruchu alebo zistíte akékoľvek ďalškosti s používaním zariadenia, obráťte sa na zákaznícku podporu so žiadostou o pomoc.
- Vyberte alternatívne miesto vpichu na zabránenie nadmerného zjazvenia, ktoré možno vytvoriť v dôsledku záťaže.
- Merajte si hladinu glukózy v krvi podľa odporúčania svojho poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti.*

*Inštitúcia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti odporúča, aby si poskytovateľ meral hladinu glukózy v krvi tri až štyrikrát denne (2018 U Oja et al., "Disruption in the diabetic device care market") a deti a mladší pacienti najmenej päťkrát denne (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

Microlet® next Nakluwacz PL

NIE Korzystać z AST w przypadku:

- Podejrzenia, że stężenie cukru we krwi jest niskie (hipoglikemia).
- Gdy stężenie cukru we krwi gwałtownie się zmienia (po posiłku, dawce insuliny lub wysiłku fizycznym).
- Gdy nie odziera się objawów niskiego stężenia cukru we krwi (bezobjawowa hipoglikemia).
- Przed i po badaniu lub użyciu glukometru, nakluwacza lub pasków testowych należy zawsze umyć ręce wodą i mydlem oraz dokładnie je osuszyć.

PRZESTROGA:

- W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia z jakiegokolwiek powodu lub trudności w obsłudze urządzenia należy skontaktować z Działem obsługi klienta.
- Naklucia należy wykonywać w różnych miejscach, aby nie dopuścić do nadmiernego bliżnaczenia, które mogłyby doprowadzić do utraty wrażliwości.
- Badania stężenia glukozy we krwi należy wykonywać z częstotliwością zalecaną (do głębokości naklucia).

Agnie ds. zdrowia zaleca, aby dorosły pacjenci badali stężenie glukozy we krwi od trzech do czterech razy dziennie (2018 U Oja et al., "Disruption in the diabetic device care market"), a dzieci i młodzież co najmniej pięć razy dziennie (2016 NICE [NG18], "Diabetes (type 1 and 2) in children and young people: diagnosis and management").

Microlet® next Odběrové zařízení CS

URČENÉ POUŽITÍ: Určeno k odběru kapilární krve, k použití společně s jednorazovými lancetami. **Odběrové zařízení MICROLET NEXT** se používá spolu s kompatibilními lancetami k odběru kapilární krve ze špičky prstu nebo z dlaně pro testování hladiny glukózy v krvi. Odběrové zařízení MICROLET NEXT je určeno pro jednoho pacienta. Odběrové zařízení není určeno pro novorozence. **Lanceta MICROLET** je jednorázová sterilní zařízení určené k odběru vzorku kapilárnej krve dospehlého nebo dítěte pro sledovanie glykémie. Lanceta není určena k použití u novorozenců. U této zařízení nejsou známy žádné kontraindikace.

POZOR:

- Použití testovací proužky a lancety vždy likvidujte jako zdravotnický odpad nebo podle pokynů zdravotnického odborníka.
- Pokaždé si umyjte ruce mydlem a dobře je vysušte před testem, před manipulací a po manipulaci s glukometrem, odběrovým zařízením nebo testovacími proužky.
- Použití testovacími proužky.

UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Souprava obsahuje malé části, které mohou v případě náhodného spolknutí způsobit udusení.
- Lanceta zůstává sterilní, dokud není odstraněn kulatý ochranný kryt. Nepoužívejte v případě poškození nebo neúmyslného otevření lancety. Likvidujte jako zdravotnický odpad, abyste zabránili případnému poranění.


UPOZORNĚNÍ: Potenciální biologické nebezpečí

- Odběrové zařízení MICROLET NEXT je určeno k samostatnému testování jediným pacientem. Z důvodu rizika infekce jej nesmí používat více osob.
- Lancety nepoužívajte opakovane. Použité lancety nejsou sterilní. Pro každé testování použijte novou lancetu.


Microlet® next Odberové zariadenie SK

ÚČEL POUŽITIA: Určené na odber kapilárnej krvi. Používa sa spolu s jednorazovými lancetami. **Odberové zariadenie MICROLET NEXT** je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie len u jedného pacienta. Odberové zariadenie nie je určené pre novorodenca. **Lanceta MICROLET** je jednorazová sterilná pomôcka určená na odber vzorkov kapilárnej krvi u dospehlých alebo detí na účely monitorovania hladiny glukózy v krvi pomocou kompatibilných lancet. Odberové zariadenie MICROLET NEXT je určené na použitie


6. Prstom pohladte dlaní a prst směrem k místu vpichu, aby se vytvořila kapka krve. Okolí místu vpichu nestláčujte.

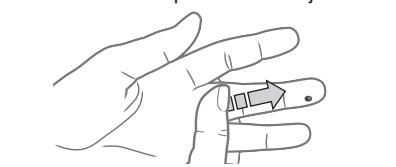

7. Udělejte test ihned po vytvoření malé kulaté kapky krve podle vyobrazení.

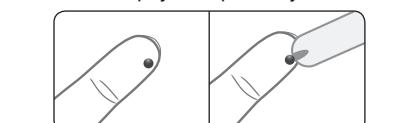

8. Místo vpichu si utřete čistým a suchým ubrouskem a poté **stlačte**, dokud krvácení neprestane.




6. Masírujte ruku a prst směrem k místu vpichu, aby se vytvořila kvapka krvi. Nestláčajte okolí místu vpichu.



7. Meranie vykonajte ihneď po tom, ako sa vytvorí malá, okrúhla kvapka krvi, ako je znázornené na obrázku.



8. Miesto vpichu si utrite čistou, suchou papierovou vreckovkou a miesto **merne tlačte**, až kým krvácание neprestane.



„Klikniecie“
„Cvaknutím“ odložte

Jeśli nie dojdzie do naktucia, zresetować powtarzając Krok 4.

6. Rozmasovacie ruke i palec v kierunku mesta naktucia, aby uformovat kropelku krvi. Nie nalezyt naciskat okolici mesta naktucia.



7. Badanie przeprowadzic natychmiast po uformowaniu sie malej, okraglej kropki krwi, jak pokazano na rysunku.



Lancetu vysuňte a zlikvidujte

UPOZORNÉNÍ


Použitou lancetu vždy zlikvidujte ako zdravotnický odpad, aby nedošlo ke zranení nebo kontaminiaci iných osôb. Pro každé testování použijte novou lancetu. **Lancety nepoužívajte opakovane.**



Vaše odberové zařízení MICROLET NEXT má výsunovací zařízení pro lancety. Lancetu z odberového zařízení nevyjmíte prsty.



8. Místo vpichu si utřete čistým a suchým ubrouskem a poté **stlačte**, dokud krvácení neprestane.

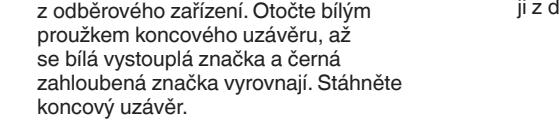

Vysunutie/likvidácia lancety

VÝSTRAHA


Použitú lancetu vždy zlikvidujte ako zdravotnický odpad, aby nedošlo k úrazu alebo kontaminiaci ostatných osôb. Pri každom meraní použite novú lancetu. **Lancety nie sú určené na opakovane použitie.**



Vaše odberové zariadenie MICROLET NEXT má vysuvať lancety. Lancetu z odberového zariadenia nevyberajte prstami.



7. Meranie vykonajte ihneď po tom, ako sa vytvorí malá, okrúhla kvapka krvi, ako je znázornené na obrázku.

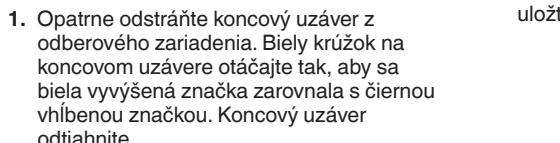

„Cvaknutím“ odložte
„Cvaknutím“ odložte

Odber kvapky krvi – dlaní

MERANIE Z ALTERNATÍVNEHO MIESTA (AM) – DLAŇ

POZNÁMKA: Použite **prieľadný** koncový uzáver na AM. Následne nastavte smerom k nádobe na ostrié predmety (napríklad k plastovej fľaši s uzáverom). Nádobu dobre označte a uložte mimo dosahu detí.



8. Nasadte a **zaistite** koncový uzáver. Zaistia sa otocením bieleho krúžku.



9. Vytrécie miesta naktucia czystą, suchą chusteczką i utrzymywać ucisk na to miejsce do chwili ustania krvawienia.



Wyjmowanie i usuwanie zużytego lancetu

OSTRZEŻENIE

Zawsze należy usuwać zużyty lancet jako odpad medyczny, aby zapobiec urazom lub zakażeniu innych osób. Do każdego badania należy używać nowego lancetu. **Nie należy używać lancetów ponownie.**



Naktuwanek MICROLET NEXT jest wyposażony w przycisk do usuwania lancetu. Nie należy wyjmować lancetu z naktuwanek palcami.



10. Umieścić zauważoną wcześniej okrągłą nasadę ochronną na płaskiej powierzchni. Pozostawiając zużyty lancet w naktuwanek, wbć lancet w środkową część nasadki.



11. Skierować urządzenie w stronę pojemnika na ostre przedmioty (np. pusta plastikowa butelka z zakrętką). Odpowiednio oznakować pojemnik i chronić go przed dziećmi.



12. Badanie przeprowadzić natychmiast po uformowaniu się małe, okrągły kropki krwi, jak pokazano na rysunku.



Uzyskiwanie kropli krwi - dłoń

ALTERNATYWNE MIEJSCE NAKŁUCIA (AST) – DŁONI

UWAGA: Użyć **przezroczystej** końcówki naktuwanek do AST.



13. Wprowadzić lancet według opisu w sekcji *Przygotowanie naktuwanek*.



14. Wprowadzić urządzenia w stronę pojemnika na ostre przedmioty (np. pusta plastikowa butelka z zakrętką). Odpowiednio oznakować pojemnik i chronić go przed dziećmi.




15. Badanie przeprowadzić natychmiast po uformowaniu się małe, okrągły kropki krwi, jak pokazano na rysunku.



Lancetu vysuňte a zlikvidujte

UPOZORNÉNÍ


Použitou lancetu vždy zlikvidujte ako zdravotnický odpad, aby nedošlo ke zranení nebo kontaminiaci iných osôb. Pro každé testování použijte novou lancetu. **Lancety nepoužívajte opakovane.**




Umísteť kulatý ochranný kryt, ktorý jste si schovali, na rovný povrch. S použitou lancetu stále v odberovém zařízení zatlačte lancetu do stredu krytu.



5. Pripojte a **zajistěte** koncový uzávěr. Otočením zajistěte bílý proužek.



6. Vyberte místo vpichu v mäsiste oblasti dlaně. Vyhnete sa žilám, materským znaménkum, kostem a sláchám.




7. Zařízení umísteť do nádoby na ostré predmety (napr. prázdná plastová láhev s uzávěrem). Nádobu dobré označte a uložte ji do dosahu detí.




8. Vyberte místo vpichu v mäsiste oblasti dlaně. Vyhnete sa žilám, materským znaménkum, kostem a sláchám.




9. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



10. Vyberte místo vpichu v mäsiste oblasti dlaně. Vyhnete sa žilám, materským znaménkum, kostem a sláchám.




11. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.




12. Vyberte místo vpichu v mäsiste oblasti dlaně. Vyhnete sa žilám, materským znaménkum, kostem a sláchám.



13. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.




14. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.

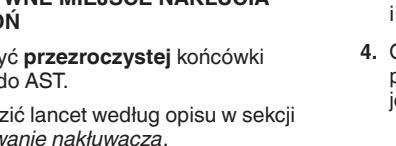

15. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



Zatlačte šedé vysunovací zařízení pro lancety dopředu, až lanceta spadne do nádoby, poté vysunovací zařízení stáhněte spět.




2. Pripojte a **zajistěte** čirý koncový uzávěr pro lancety dopředu, až lanceta spadne do nádoby, poté vysunovací zařízení stáhněte spět.



3. Zařízení umísteť do nádoby na ostré predmety (napr. prázdná plastová láhev s uzávěrem). Nádobu dobré označte a uložte ji do dosahu detí.



4. Vyberte místo vpichu v mäsiste oblasti dlaně. Vyhnete sa žilám, materským znaménkum, kostem a sláchám.




5. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.




6. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



7. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.




8. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



9. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



10. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



11. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



12. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



13. Zařízení neoddalujte od dlaně. Udržuje stálý tlak, dokud se pod čirým koncovým uzávěrem nevytvorí malá kulatá kapka krve.



14. Zař